indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C
Linha Odontológica
Linha Hospitalar
Linha Personalizada

Consultar Instruções de Utilização
Não Estéril
Manter Afastado da Luz do Sol
Manter Seco

Estojos Autoclaváveis para esterilização de instrumentos

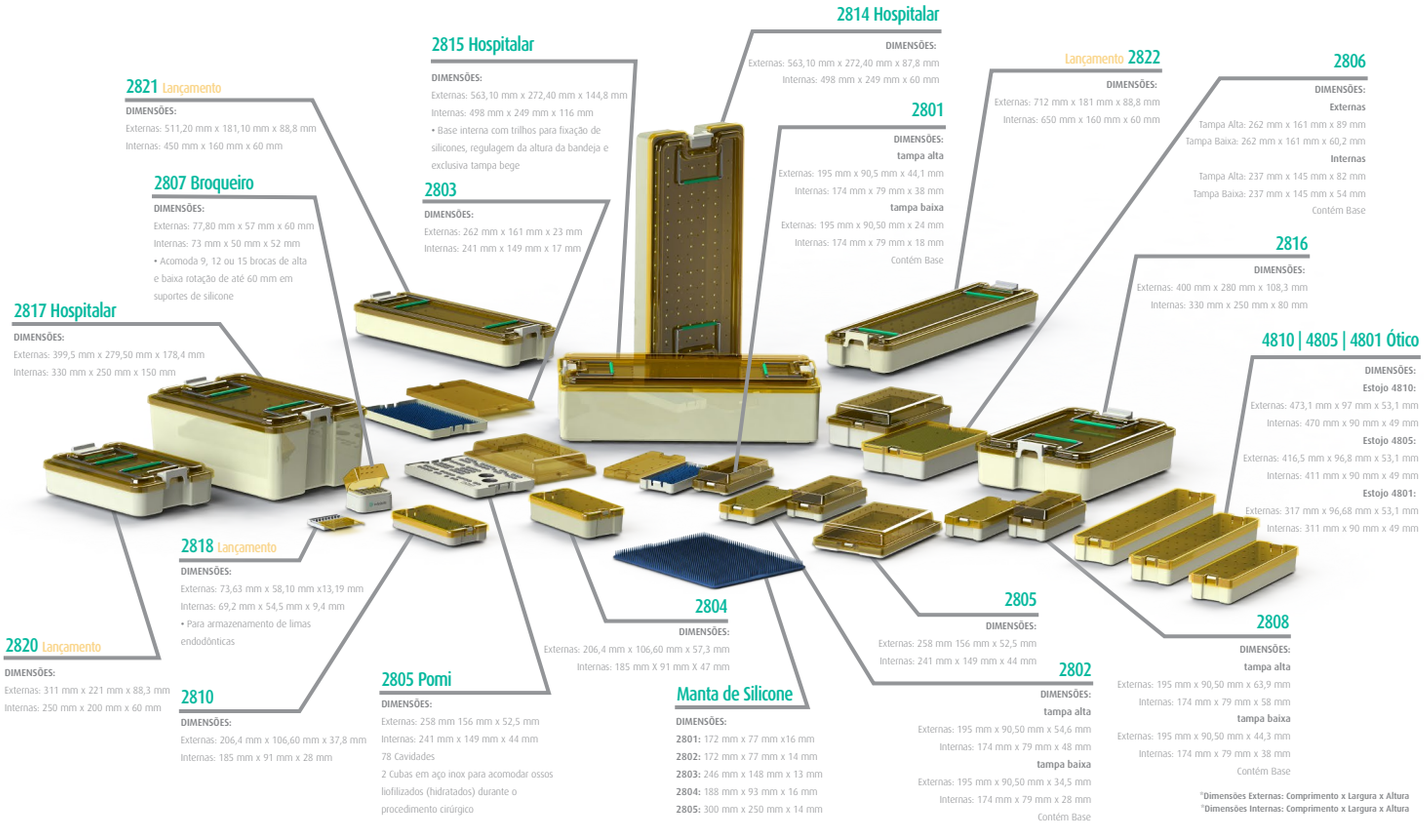

2821 Lançamento
DIMENSÕES:
Externas: 511,20 mm x 181,10 mm x 88,8 mm
Internas: 450 mm x 160 mm x 60 mm

2807 Broqueiro
DIMENSÕES:
Externas: 77,80 mm x 57 mm x 60 mm
Internas: 73 mm x 50 mm x 52 mm
• Acomoda 9, 12 ou 15 brocas de alta e baixa rotação de até 60 mm em suportes de silicone

2817 Hospitalar
DIMENSÕES:
Externas: 399,5 mm x 279,50 mm x 178,4 mm
Internas: 330 mm x 250 mm x 150 mm

2820 Lançamento
DIMENSÕES:
Externas: 311 mm x 221 mm x 88,3 mm
Internas: 250 mm x 200 mm x 60 mm

2818 Lançamento
DIMENSÕES:
Externas: 73,63 mm x 58,10 mm x13,19 mm
Internas: 69,2 mm x 54,5 mm x 9,4 mm
• Para armazenamento de limas endodônticas

2810
DIMENSÕES:
Externas: 206,4 mm x 106,60 mm x 37,8 mm
Internas: 185 mm x 91 mm x 28 mm

2815 Hospitalar
DIMENSÕES:
Externas: 563,10 mm x 272,40 mm x 144,8 mm
Internas: 498 mm x 249 mm x 116 mm
• Base interna com trilhos para fixação de silicones, regulagem da altura da bandeja e exclusiva tampa bege

2803
DIMENSÕES:
Externas: 262 mm x 161 mm x 23 mm
Internas: 241 mm x 149 mm x 17 mm

2805 Pomi
DIMENSÕES:
Externas: 258 mm 156 mm x 52,5 mm
Internas: 241 mm x 149 mm x 44 mm
78 Cavidades
2 Cubas em aço inox para acomodar ossos liofilizados (hidratados) durante o procedimento cirúrgico

2814 Hospitalar
DIMENSÕES:
Externas: 563,10 mm x 272,40 mm x 87,8 mm
Internas: 498 mm x 249 mm x 60 mm

2801
DIMENSÕES:
tampa alta
Externas: 195 mm x 90,5 mm x 44,1 mm
Internas: 174 mm x 79 mm x 38 mm
tampa baixa
Externas: 195 mm x 90,50 mm x 24 mm
Internas: 174 mm x 79 mm x 18 mm
Contém Base

2804
DIMENSÕES:
Externas: 206,4 mm x 106,60 mm x 57,3 mm
Internas: 185 mm X 91 mm X 47 mm

Manta de Silicone
DIMENSÕES:
2801: 172 mm x 77 mm x16 mm
2802: 172 mm x 77 mm x 14 mm
2803: 246 mm x 148 mm x 13 mm
2804: 188 mm x 93 mm x 16 mm
2805: 300 mm x 250 mm x 14 mm

Lançamento **2822**
DIMENSÕES:
Externas: 712 mm x 181 mm x 88,8 mm
Internas: 650 mm x 160 mm x 60 mm

2806
DIMENSÕES:
Externas
Tampa Alta: 262 mm x 161 mm x 89 mm
Tampa Baixa: 262 mm x 161 mm x 60,2 mm
Internas
Tampa Alta: 237 mm x 145 mm x 82 mm
Tampa Baixa: 237 mm x 145 mm x 54 mm
Contém Base

2816
DIMENSÕES:
Externas: 400 mm x 280 mm x 108,3 mm
Internas: 330 mm x 250 mm x 80 mm

4810 | 4805 | 4801 Ótico
DIMENSÕES:
Estojo 4810:
Externas: 473,1 mm x 97 mm x 53,1 mm
Internas: 470 mm x 90 mm x 49 mm
Estojo 4805:
Externas: 416,5 mm x 96,8 mm x 53,1 mm
Internas: 411 mm x 90 mm x 49 mm
Estojo 4801:
Externas: 317 mm x 96,68 mm x 53,1 mm
Internas: 311 mm x 90 mm x 49 mm

2805
DIMENSÕES:
Externas: 258 mm 156 mm x 52,5 mm
Internas: 241 mm x 149 mm x 44 mm

2802
DIMENSÕES:
tampa alta
Externas: 195 mm x 90,50 mm x 54,6 mm
Internas: 174 mm x 79 mm x 48 mm
tampa baixa
Externas: 195 mm x 90,50 mm x 34,5 mm
Internas: 174 mm x 79 mm x 28 mm
Contém Base

2808
DIMENSÕES:
tampa alta
Externas: 195 mm x 90,50 mm x 63,9 mm
Internas: 174 mm x 79 mm x 58 mm
tampa baixa
Externas: 195 mm x 90,50 mm x 44,3 mm
Internas: 174 mm x 79 mm x 38 mm
Contém Base

*Dimensões Externas: Comprimento x Largura x Altura
*Dimensões Internas: Comprimento x Largura x Altura

- Não apresentam cantos vivos
- Fácil higiene e esterilização
- Alta performance e durabilidade
- Leves e fáceis de transportar
- Autoclaváveis

O amplo portfólio de Estojos Autoclaváveis Indusbello oferece diversas funcionalidades para as exigências da área odontológica e hospitalar.

Os termoplásticos de engenharia apresentam melhores propriedades térmicas e mecânicas que os convencionais, por isso a Indusbello optou pelo que há de mais tecnológico na composição de seus estojos autoclaváveis. Esta decisão inovadora permite que os estojos suportem as mais altas temperaturas dos múltiplos ciclos da autoclave e garanta vida útil prolongada com as mesmas propriedades iniciais.

Além disso, a elevada resistência os protegem de substâncias altamente corrosivas, compressão e fortes impactos. Em relação ao design, a inclusão de tampas translúcidas facilita a visualização dos equipamentos internos, os cantos arredondados facilitam a limpeza e higienização aumentando a biossegurança devido à ausência de cantos vivos, a leveza da matéria-prima torna o transporte e manuseio mais eficientes.

A resistência ao impacto é muito importante para suportar quedas não intencionais e aumentar a vida útil dos estojos.

INSTRUÇÕES DE USO: Para abrir o Estojo Para Esterilização, as travas laterais devem ser desativadas com a ajuda dos dedos polegar e indicador de cada mão simultaneamente; abrir e acomodar os materiais que deseja autoclavar; Para os modelos que acompanham a Manta de silicone, os instrumentos devem ser acomodados sobre a mesma; Nos modelos que acompanham perfis, os instrumentos são encaixados no mesmo.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando detergente enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso. Atenção: Evite contato com produtos químicos (solvente, hidrocarbonetos clorados), pois pode resultar em deterioração.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

PRECAUÇÕES: Produto indicado para esterilização em autoclave. Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Produto não estéril. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

COMPOSIÇÃO: Polímero e Silicone Atóxico.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
106059102511	Estojo 2801 Protético	1 estojo	I 80213420030
106059102507	Estojo 2801 com manta	1 estojo	I 80213420032
106059102516	Estojo 2801 com perfil	1 estojo | 2 perfis com 4 cavidades grande	I 80213420033
106059102518	Estojo 2801 com perfil	1 estojo | 2 perfis com 5 cavidades grande	
106059100110	Estojo 2802 Protético	1 estojo	
106059102512	Estojo 2802	1 estojo	
106059102508	Estojo 2802 com manta	1 estojo | 2 mantas	
106059102513	Estojo 2803	1 estojo	
106059100014	Estojo 2803 com tampa fume	1 estojo	
106059102509	Estojo 2803 com manta	1 estojo | 1 manta	
106059102517	Estojo 2803 com perfil	1 estojo | 2 perfis com 10 cavidades pequena	
106059102522	Estojo 2803 com perfil	1 estojo | 2 perfis com 10 cavidades grande	
106059102514	Estojo 2804	1 estojo	
106059100387	Estojo 2804 com manta	1 estojo | 2 mantas	
106059102510	Estojo 2804 com manta	1 estojo | 3 mantas	
106059102519	Estojo 2805 POMI	1 estojo	
106059102520	Estojo 2806	1 estojo	
106059102521	Estojo 2806 com manta e base	1 estojo | 1 manta e 1 base	
106059102523	Estojo 2806 com manta	1 estojo | 1 manta	
106059102524	Estojo 2806 com base	1 estojo | 1 base	
106059101153	Estojo 2806 com manta	1 estojo | 2 mantas	
106059102525	Estojo 2806 com manta e base	1 estojo | 2 manta e 1 base	
106059100188	Estojo 2806 tampa alta com manta	1 estojo | 2 mantas	
106059100890	Estojo 2806 tampa alta com manta e base	1 estojo | 1 manta e 1 base	
106059102504	2807 Broqueiro 9 furos | alta rotação	1 estojo	
106059102501	2807 Broqueiro 9 furos | baixa rotação	1 estojo	
106059102505	2807 Broqueiro 12 furos | alta rotação	1 estojo	
106059102502	2807 Broqueiro 12 furos | baixa rotação	1 estojo	
106059102506	2807 Broqueiro 15 furos | alta rotação	1 estojo	
106059102503	2807 Broqueiro 15 furos | baixa rotação	1 estojo	
106059100120	Estojo 2808 Protético	1 estojo	
106059100130	Estojo 2808 com manta e base	1 estojo | 1 manta e 1 base	
106059100131	Estojo 2808 com manta e base	1 estojo | 2 mantas e 1 base	
105888100036	Estojo 2810	1 estojo	
106060101747	Estojo 2814 Hospitalar	1 estojo	
106060102528	Estojo 2815 Hospitalar	1 estojo	
106060101740	Estojo 2815 Hospitalar com fundo	1 estojo e fundo	
106060102529	Estojo 2816 Hospitalar	1 estojo	
106060102530	Estojo 2817 Hospitalar	1 estojo	
106060100003	Estojo 2818 (porta-limas) – Tampa e fundo	1 estojo	
106060102535	Estojo 2820 com base	1 estojo	
106060102536	Estojo 2821	1 estojo	
106060102537	Estojo 2822	1 estojo	
106060102531	Estojo 4801 Ótico	1 estojo	
106060102532	Estojo 4805 Ótico	1 estojo	
106060102533	Estojo 4810 Ótico	1 estojo	
106552102004	Manta de Silicone Modelo 2801	1 unidade	
106552102005	Manta de Silicone Modelo 2802	1 unidade	
106552102002	Manta de Silicone Modelo 2803	1 unidade	
106552102003	Manta de Silicone Modelo 2804	1 unidade	
106552102001	Manta de Silicone Modelo 2805	1 unidade	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net